

FIG. 1




FIG. 2

SPECIFIED VALUE μ L	RESULTS			
	SUCKED		DISCHARGED	
0.99	mean	1.99	mean	0.81
	SD	0.09	SD	0.06
	CV (%)	4.54	CV (%)	7.74
1.98	mean	2.88	mean	1.85
	SD	0.07	SD	0.05
	CV (%)	2.58	CV (%)	2.70
4.98	mean	6.21	mean	4.60
	SD	0.04	SD	0.08
	CV (%)	0.69	CV (%)	1.71
10.01	mean	11.09	mean	9.72
	SD	0.06	SD	0.07
	CV (%)	0.58	CV (%)	0.73
40.01	mean	40.74	mean	39.55
	SD	0.09	SD	0.10
	CV (%)	0.21	CV (%)	0.26

FIG. 3

SPECIFIED VALUE μL	RESULTS			
	SUCKED		DISCHARGED	
0.99	mean	2.46	mean	1.39
	SD	0.09	SD	0.13
	CV (%)	3.49	CV (%)	9.01
1.98	mean	3.43	mean	2.33
	SD	0.06	SD	0.14
	CV (%)	1.75	CV (%)	5.89
4.98	mean	6.19	mean	5.22
	SD	0.09	SD	0.10
	CV (%)	0.69	CV (%)	1.93
10.01	mean	10.95	mean	10.49
	SD	0.12	SD	0.10
	CV (%)	1.06	CV (%)	0.97
40.01	mean	38.81	mean	38.33
	SD	0.05	SD	0.08
	CV (%)	0.13	CV (%)	0.21

FIG. 4




FIG.5




FIG. 6

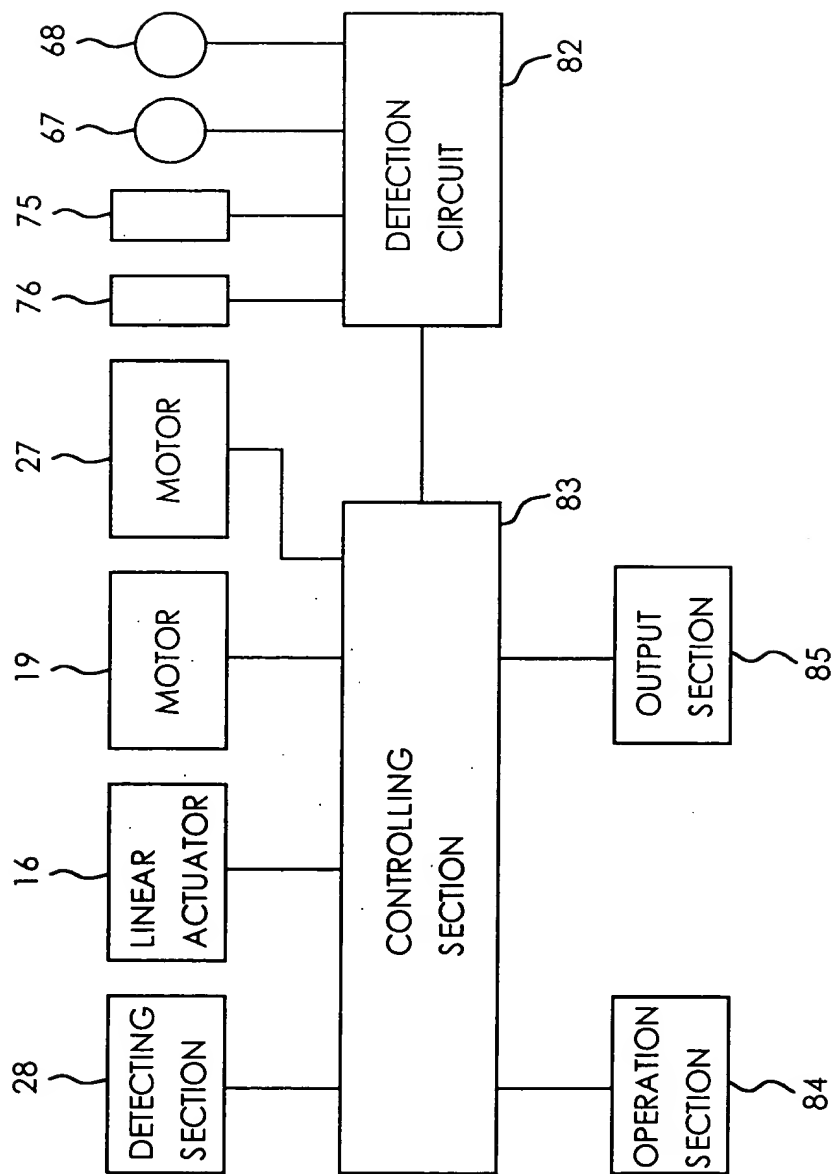


FIG.7




FIG.8

